




Посуда лабораторная медицинская полимерная. Пробирка центрифужная коническая ПЗЦ-16-100-ПП

Посуда лабораторная медицинская полимерная. Пробирка центрифужная коническая ПЗЦ-16-100-ПП (стерильная, в групповой упаковке)



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Пробирка центрифужная коническая ПЗЦ-16-100-ПП (нестерильная, в групповой упаковке)



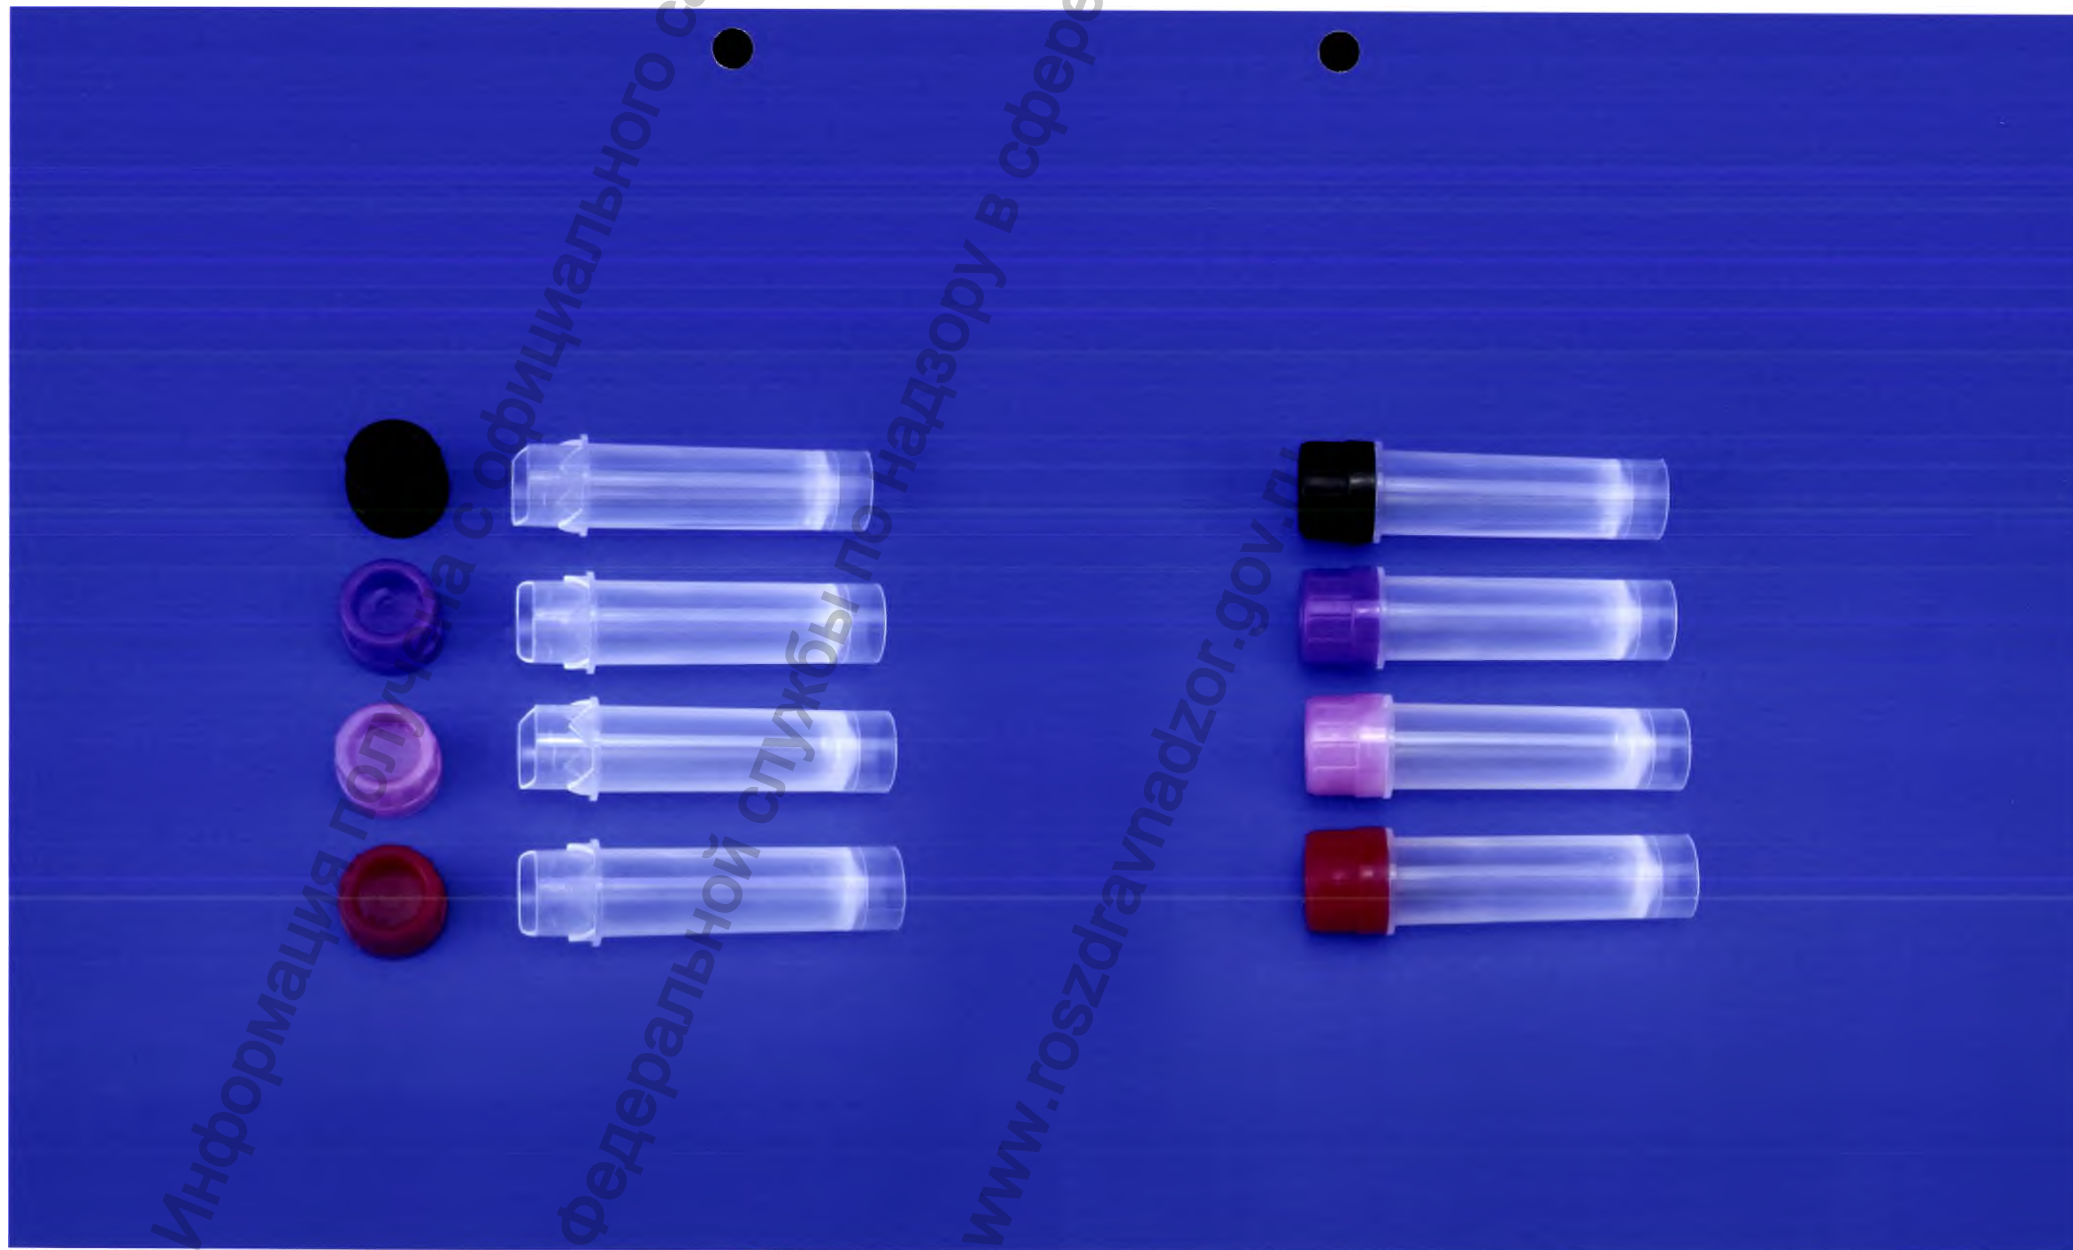

a)

b)

Посуда лабораторная медицинская полимерная. Микропробирка с юбкой устойчивости
ПМ2ЮК-15-46-ПП с красной/ розовой/ фиолетовой/ черной пробкой
a) микропробирка+пробка б) в сборе



13.02.2019. 2. LOT 2

ПЕРИНТ
МИКРОПРОБИРКА
С ЮБКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПМ2ЮК-15-46-ПП

Диаметр: 13 мм
Высота: 47 мм
Объем: 1,5 мл

100 шт.

• для взятия и хранения биологических материалов;
• для проведения химических реакций.

СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/10723 от 6 мая 2011 года
Посуда лабораторная медицинская полимерная
по ТУ 9398-002-54287340-2010

Производитель: ЗАО "Перинт"
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Фучика, д. 12, к. 2
www.perint.ru

Гарантийный срок годности
3 года с даты изготовления

Дата изготовления: смотри на упаковке

LOT : смотри на упаковке



STERILE

Посуда лабораторная медицинская полимерная. Микропробирка с юбкой устойчивости
ПМ2ЮК-15-46-ПП с розовой пробкой (стерильная, в групповой упаковке)



13.02.2019. 2 LOT 2

ПЕРИНТ
МИКРОПРОБИРКА
С ЮБКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПМ2ЮК-15-46-ПП

Диаметр: 13 мм
Высота: 47 мм
Объем: 1,5 мл

100 шт.

для взятия и хранения биологических материалов;
для проведения химических реакций.

НЕСТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

Регистрационное удостоверение
№ 2011/10723 от 6 мая 2011 года
Посуда лабораторная медицинская полимерная
по ТУ 9398-002-54287340-2010

Производитель: ЗАО "Перинт"
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Фучика, д. 12, к. 2
www.perint.ru


Гарантийный срок годности
3 года с даты изготовления

Дата изготовления: смотри на упаковке

LOT : смотри на упаковке



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Микропробирка с юбкой устойчивости ПМ2ЮК-15-46-ПП с розовой пробкой (нестерильная, в групповой упаковке)

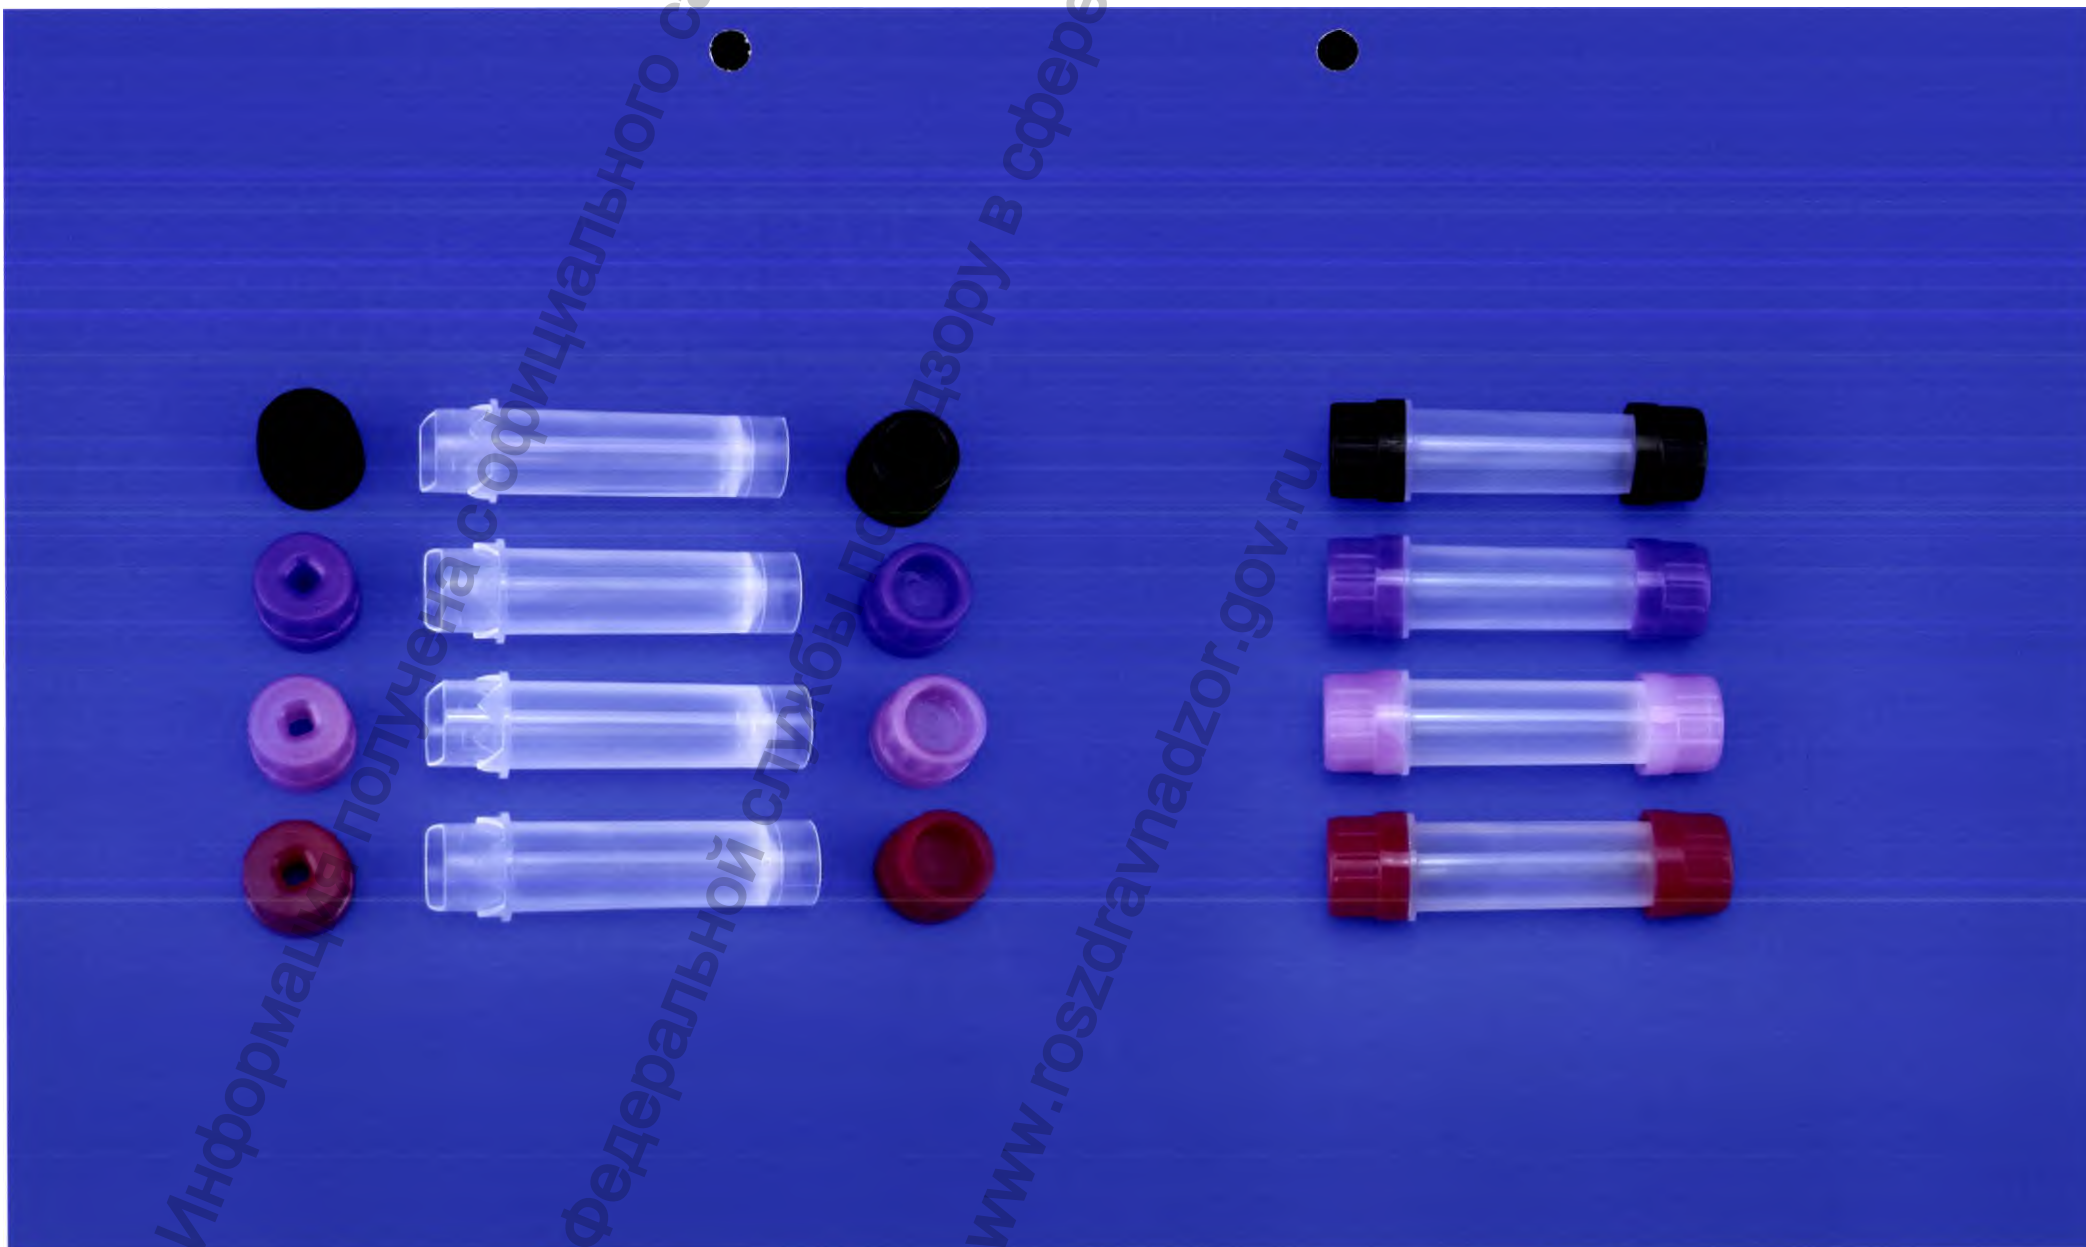

а)

б)

Посуда лабораторная медицинская полимерная. Микропробирка с юбкой устойчивости ПМ2ЮК-15-46-ПП
с красной/ розовой/ фиолетовой / черной пробкой и красной/ розовой фиолетовой / черной пробкой с отверстием
а) микропробирка+пробка+ пробка с отверстием б) в сборе

13.02.2019 LOT 2

ПЕРИНТ
МИКРОПРОБИРКА
С ЮБКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПМ2ЮК-15-46-ПП

Диаметр: 13 мм
Высота: 47 мм
Объем: 1,5 мл

100 шт.

- для взятия и хранения биологических материалов;
- для проведения химических реакций.

СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/10723 от 6 мая 2011 года
Посуда лабораторная медицинская полимерная
по ТУ 9398-002-54287340-2010

Производитель: ЗАО "Перинт"
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Фучика, д. 12, к. 2
www.perint.ru

Гарантийный срок годности
3 года с даты изготовления

Дата изготовления: смотри на упаковке

LOT : смотри на упаковке



13.02.2019 LOT 2

➔ ПЕРИНТ

ПРОБИРКА
ЦЕНТРИФУЖНАЯ КОНИЧЕСКАЯ
ПЗЦ-16-100-ПП

Диаметр: 16 мм

Высота: 100 мм

Объем: 10 мл

100 шт.

- для взятия и хранения биологических материалов;
- для проведения химических реакций.

НЕСТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/10723 от 6 мая 2011 года

Посуда лабораторная медицинская полимерная
по ТУ 0198-002-54287340-2010

Производитель: ЗАО "Перинт"
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Фучика, д. 12, к. 2
www.perint.ru

Гарантийный срок годности
3 года с даты изготовления

Дата изготовления: смотри на упаковке

LOT : смотри на упаковке



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramadzor.gov.ru



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Микропробирка круглодонная ПМ2К-13-40-ПП

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

13.02.2019 2 LOT 2

ПЕРИНТ

**МИКРОПРОБИРКА
КРУГЛОДОННАЯ
ПМ2К-13-40-ПП**

Диаметр: 13 мм
Высота: 40 мм
Объем: 2,0 мл

100 шт.

- для взятия и хранения биологических материалов;
- для проведения химических реакций.

СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/10723 от 6 мая 2011 года
Посуда лабораторная медицинская полимерная
по ТУ 9398-002-54287340-2010

Производитель: ЗАО "Перинт"
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Фучика, д. 12, к. 2
www.perint.ru

Гарантийный срок годности
3 года с даты изготовления

Дата изготовления: смотри на упаковке

LOT : смотри на упаковке



STERILE

Посуда лабораторная медицинская полимерная. Микропробирка круглодонная
ПМ2К-13-40-ПП (стерильная, в групповой упаковке)

13.02.2019 2 LOT 2

ПЕРИНТ

**МИКРОПРОБИРКА
КРУГЛОДОННАЯ
ПМ2К-13-40-ПП**

Диаметр: 13 мм
Высота: 40 мм
Объем: 2,0 мл

100 шт.

- для взятия и хранения биологических материалов;
- для проведения химических реакций.

НЕСТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/10723 от 6 мая 2011 года
Посуда лабораторная медицинская полимерная
по ТУ 9398-002-54287340-2010

Производитель: ЗАО "Перинт"
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Фучика, д. 12, к. 2
www.perint.ru

Гарантийный срок годности
3 года с даты изготовления

Дата изготовления: смотри на упаковке

LOT : смотри на упаковке



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Микропробирка круглодонная
ПМ2К-13-40-ПП (нестерильная, в групповой упаковке)

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.gosdrazhnadzor.gov.ru



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Микропробирка коническая ПМЗК-13-40-ПП

13.02.2019. 2. LOT 2

➔ ПЕРИНТ

МИКРОПРОБИРКА
КОНИЧЕСКАЯ
ПМЗК-13-40-ПП

Диаметр: 13 мм
Высота: 40 мм
Объем: 1,5 мл

100 шт.

- для взятия и хранения биологических материалов;
- для проведения химических реакций.

СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

Регистрационное удостоверение
№ФСР 2011/10723 от 6 мая 2011 года
Посуда лабораторная медицинская полимерная
по ТУ 9398-002-54287340-2010

Производитель: ЗАО "Перинт"
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Фучика, д. 12; к. 2
www.perint.ru

Гарантийный срок годности
3 года с даты изготовления

Дата изготовления: смотри на упаковке

LOT : смотри на упаковке



STERILE

PP

Посуда лабораторная медицинская полимерная. Микропробирка коническая
ПМЗК-13-40-ПП (стерильная, в групповой упаковке)

13.02.2019. 2. LOT 2

ПЕРИНТ
МИКРОПРОБИРКА
КОНИЧЕСКАЯ
ПМЗК-13-40-ПП

Диаметр: 13 мм
Высота: 40 мм
Объем: 1,5 мл

100 шт.

- для взятия и хранения биологических материалов;
- для проведения химических реакций.

НЕСТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/10723 от 6 мая 2011 года

Посуда лабораторная медицинская полимерная
по ТУ 9398-002-54287340-2010

Производитель: ЗАО "Перинт"
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Фучика, д. 12, к. 2
www.perint.ru

Гарантийный срок годности
3 года с даты изготовления

Дата изготовления: смотри на упаковке

LOT : смотри на упаковке



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Микропробирка коническая
ПМЗК-13-40-ПП (нестерильная, в групповой упаковке)

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdrazhnadzor.gov.ru



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Чашка Петри одноразовая ЧБН1-В-14х60 ПС



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Чашка Петри одноразовая
ФСН1-В-14х60 ПС (в индивидуальной упаковке)



13.04.2018 LOT 4
СМЕНА № 3

↑ ПЕРИИТ

ЧБН1-В-14х60 ПС

Чашка Петри одноразовая

СТЕРИЛЬНО

STERILE R

Диаметр: 60 мм

Высота: 14 мм


10 шт.

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/10723 от 6 мая 2011 года
ТУ 9398-002-54287340-2010

Производитель: ЗАО «Перинт»
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург
ул. Фучика, д. 12, к. 2


Гарантийный срок хранения
3 года с даты производства

НЕТОКСИЧНО



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Чашка Петри одноразовая
ЧБН1-В-14х60 ПС (в групповой упаковке)

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdrazhnadzor.gov.ru

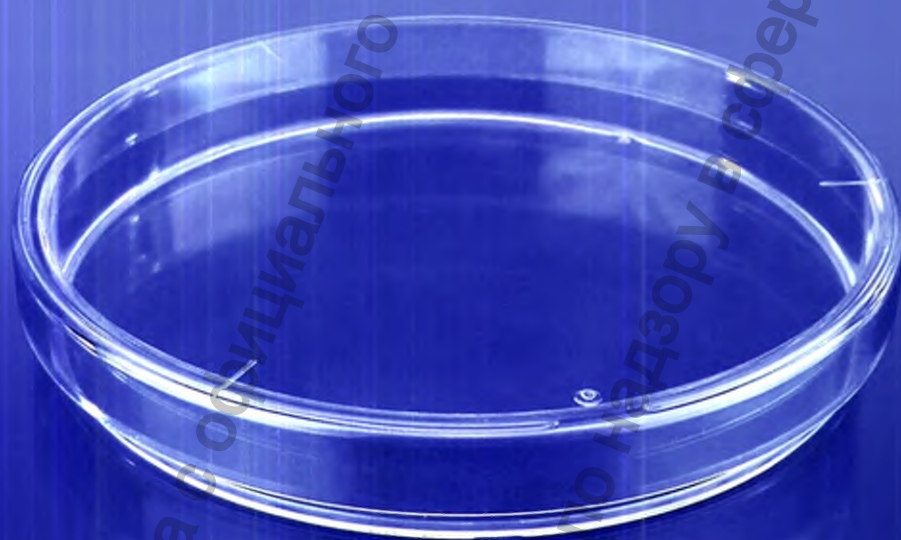

Посуда лабораторная медицинская полимерная. Чашка Петри одноразовая ЧБН1-В-14х90 ПС



Посуда лабораторная медицинская полимерная.

Чашка Петри одноразовая ЧБН1-В-14х90 ПС (в индивидуальной упаковке)



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Чашка Петри одноразовая ЧБН1-В-14х90 ПС

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdrazhnadzor.gov.ru



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Чашка Петри одноразовая ЧБН2-В-14х90 ПС



ПЕРИИТ

ЧАШКА ПЕТРИ ОДНОРАЗОВАЯ 2-х СЕКЦИОННАЯ
ЧБН2-В-14Х90 ПС

Диаметр: 90 мм
Высота: 14 мм

- для использования в микробиологии;
- для культивирования колоний микроорганизмов;
- для хранения мелких фрагментов различных препаратов и т.д.

СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

Регистрационное удостоверение
ФСР 2011/10723 от 06 мая 2011 года

Посуда лабораторная медицинская полимерная
ТУ 9398-002-54287340-2010

Производитель: ЗАО «Перинт»
Адрес: 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Фрунзе, д. 12, к. 2

Гарантийный срок годности
3 года с даты производства

Дата изготовления: см. стр. на упаковке



STERILE R


Посуда лабораторная медицинская полимерная.

Чашка Петри одноразовая ЧБН2-В-14х90 ПС (в индивидуальной упаковке)



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Чашка Петри одноразовая
ЧБН2-В-14х90 ПС (в групповой упаковке)

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdrazhnadzor.gov.ru

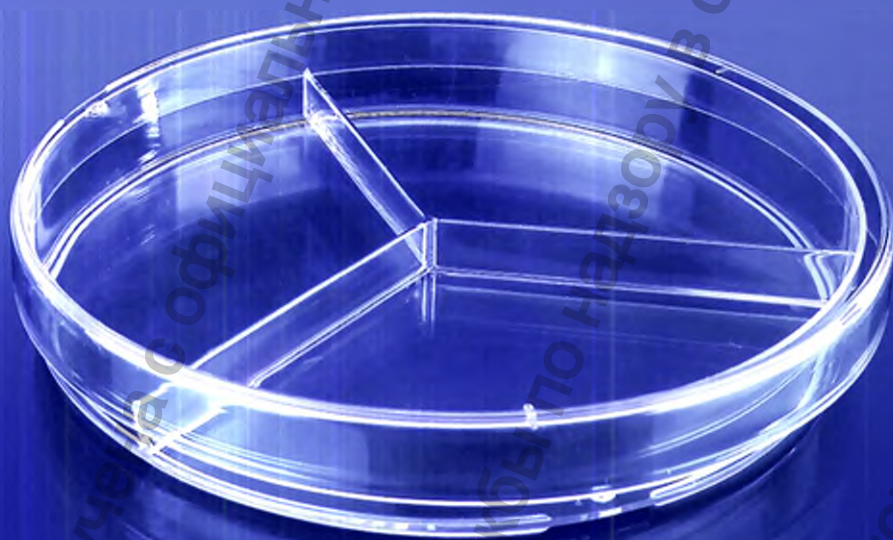

Посуда лабораторная медицинская полимерная. Чашка Петри одноразовая ЧБНЗ-В-14х90 ПС




Посуда лабораторная медицинская полимерная. Чашка Петри одноразовая
ЧБНЗ-В-14х90 ПС (в индивидуальной упаковке)



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Чашка Петри одноразовая
ЧБНЗ-В-14х90 ПС (в групповой упаковке)

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramadzor.gov.ru

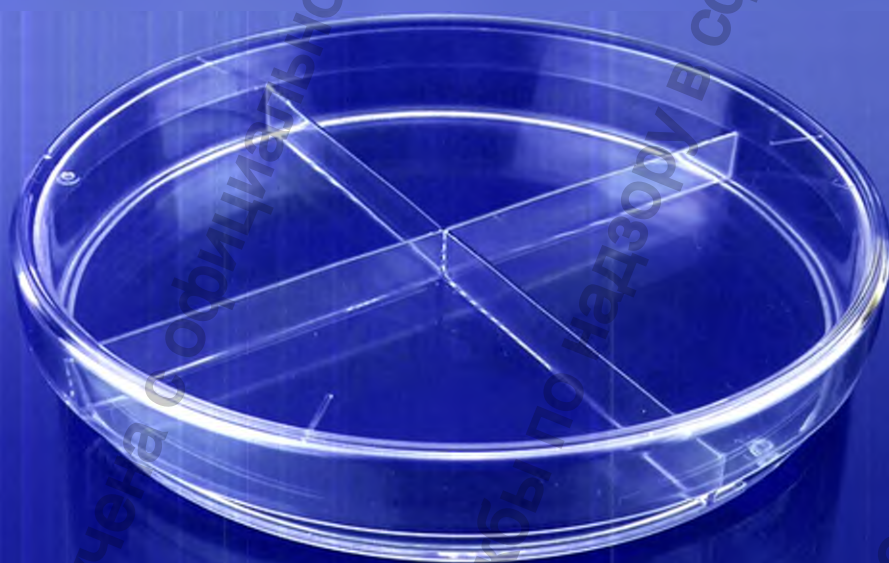

Посуда лабораторная медицинская полимерная. Чашка Петри одноразовая ЧБН4-В-14х90 ПС



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Чашка Петри одноразовая
ЧБН4-В-14х90 ПС (в индивидуальной упаковке)



Посуда лабораторная медицинская полимерная.

Чашка Петри одноразовая ЧБН4-В-14х90 ПС (в групповой упаковке)

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdrazhnadzor.gov.ru



Посуда лабораторная медицинская полимерная. стакан СН2 -30-ПП



ПЕРИНТ
Производитель
340 Перинт
192102, Россия
Санкт-Петербург, ул. Фрунзе
12, корп. 2
www.perint.ru
Посуда лабораторная медицинская полимерная

627144-53340
штук / pcs

Стакан СН2-30-ПП

LOT	1
Смена №	5 / 0
№ 005	
НЕТОКСИЧНО	
СТЕРИЛЬНО	

ТУ 6386-002-54287340-2010

8356000300031300005300119005005

Кол-во/Qty: 100 шт/pcs
Дата изг./Mdf: 30.01.19
Р/у № ФСР 2011/10723 от 06.05.11

5
PP

01.2022

Посуда лабораторная медицинская полимерная.
Стакан СН2-30-ПП (стерильный, в групповой упаковке)



ПЕРИНТ
www.perint.ru
Посуда лабораторная медицинская полимерная

Производитель:
ЗАО "Перинт"
192104, Россия
С/адрес: Гатчинский ул. Бульвар
12, этаж 2

627144 555340
штук / pcs

Стакан СН2-30-ПП

LOT	1
Смена №	5 / 0
№ доз	
НЕТОКСИЧНО	
НЕСТЕРИЛЬНО	

ТУ 9386-002-54287340-2010

8355000300031300005300119025005

Кол-во/Qty: 100 шт/pcs
Дата изг./Mdf: 30.01.19
Р/у № ФСР 2011/П0723 от 08.05.11
от 2022

5
PP

100%
100%
100%

Посуда лабораторная медицинская полимерная.
Стакан СН2-30-ПП (нестерильный, в групповой упаковке)



Посуда лабораторная медицинская полимерная. стакан СН1 -50-ПП

18072019 2 1015
ПЕРИНТ

**СТАКАН
СН1-50-ПП**

Диаметр: 42 мм
Высота: 60 мм
Объем: 50 мл

12 шт.

СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/10723 от 6 мая 2011 года
Посуда лабораторная медицинская полимерная
по ТУ 9398-002-54287340-2010

Производитель: ЗАО "Перинт"
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Фучика, д. 12, к. 2
www.perint.ru

Гарантийный срок годности
3 года с даты изготовления

Дата изготовления: смотри на упаковке
LOT - смотри на упаковке

2



5



STERILE

PP

Посуда лабораторная медицинская полимерная.
Стакан СН1 -50-ПП (стерильный, в групповой упаковке)



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Стакан СН1 -50-ПП (нестерильный, в групповой упаковке)



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramadzor.gov.ru

Посуда лабораторная медицинская полимерная. стакан СН1 -100-ПП



ПЕРИНТ

**СТАКАН
СН1-100-ПП**

Диаметр: 52 мм
Высота: 72 мм
Объем: 100 мл

12 шт.

СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/10723 от 6 мая 2011 года
Посуда лабораторная медицинская полимерная
по ТУ 9398-002-54287340-2010

Производитель: ЗАО "Перинт"
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Фучика, д. 12, к. 2
www.perint.ru

Гарантийный срок годности
3 года с даты изготовления

Дата изготовления: смотри на упаковке

LOT: смотри на упаковке

2



5
PP

STERILE

Посуда лабораторная медицинская полимерная.
Стакан СН1 -100-ПП (стерильный, в групповой упаковке)



Посуда лабораторная медицинская полимерная. Стакан СН1 -100-ПП (нестерильный, в групповой упаковке)



Посуда лабораторная медицинская полимерная. стакан СН1 -250-ПП

3. ПЕРУИТ

СТАКАН
СН1-250-ПП

Диаметр: 72 мм
Высота: 96 мм
Объем: 250 мл

6 шт.

СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/10723 от 6 мая 2011

Посуда лабораторная медицинская полимерная
по ТУ 9398-002-54287346-2010

Производитель: ЗАО "Перуит"
Россия, 192002, г. Санкт-Петербург,
ул. Фучикади, 12, к. 2
www.peruit.ru

Гарантийный срок годности
3 года с даты изготовления

Дата изготовления: смотри на упаковке
LOT : смотри на упаковке




STERILE

PP

001

Посуда лабораторная медицинская полимерная.
Стакан СН1 -250-ПП (стерильный, в групповой упаковке)

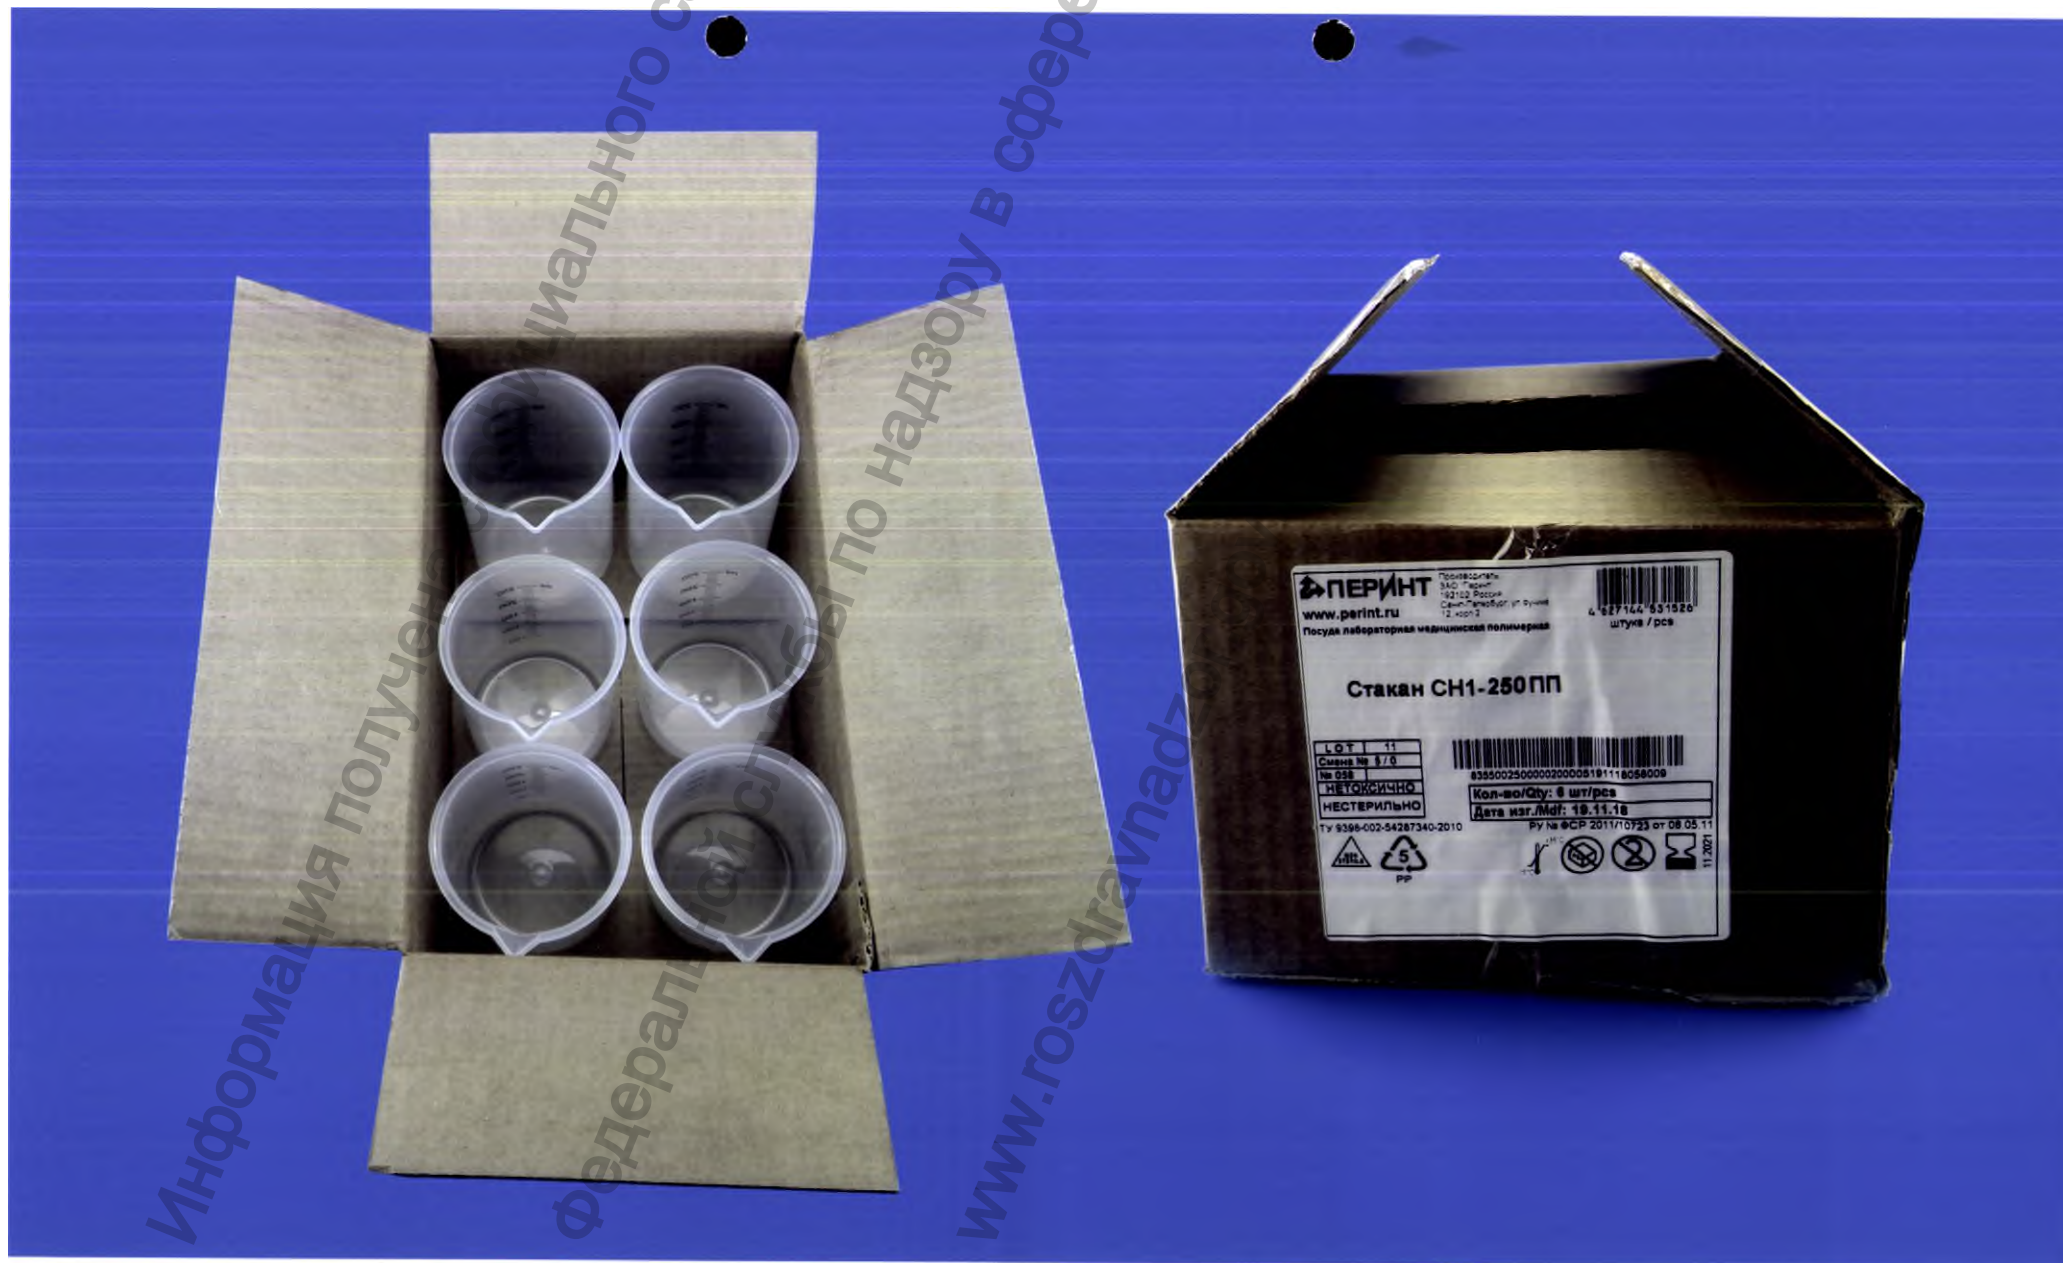

Посуда лабораторная медицинская полимерная. Стакан СН1 -250-ПП (нестерильный, в групповой упаковке)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью ЗАО «Перинт» 42 л.

Генеральный директор ЗАО «Перинт»

М.Я. Моносов



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdraznadzor.gov.ru